WD-150

ウォッシャーディスインフェクター

Thinking ahead. Focused on life.

WD-150

歯科診療にさらなる安全と効率を

インスツルメントやハサミなど、先端の鋭利な器具の手洗いによる洗浄は、切創のリスクだけでなく、感染の原因になる危険性があります。洗浄・消毒作業を全自動で行う器具除染洗浄機「WD-150」が、これらの問題を解決し、日々の歯科診療にさらなる安全と効率をもたらします。

洗浄・消毒にかかる業務を効率化

器具の洗浄・消毒から乾燥を、全自動で行うことが可能ですので、手洗いに割いていた時間を患者さんの診療やケアの向上に注力していただくことができます。

洗浄中のケガによる感染を防止

手洗いの場合、手袋をしていたとしても、先端の尖った器具や鋭利なハサミなどでケガをする恐れがあります。WD-150は自動で洗浄・消毒が行えるため、切創による感染のリスクを未然に防ぐことができます。

洗浄・消毒業務のレベルを均一化

器具の溝やタービンの細管内部など、細かい部分まで洗浄・消毒ができるため、作業者の経験や知識に関係なく、作業レベルを均一化させることができます。

収納例
- バット………………22枚
- ハンドピース類……10本
- 吸引管………………10本
- 鉗子類……………… 7本
- IMSカセット
- インスツルメント、リーマー、ファイルスタンド ほか

Features
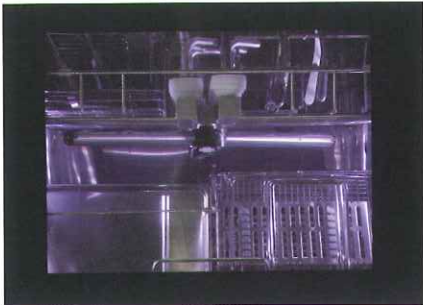
洗浄室内の様子が一目でわかるシースルーパネル

洗浄室内の様子が確認できるシースルーパネルを採用。
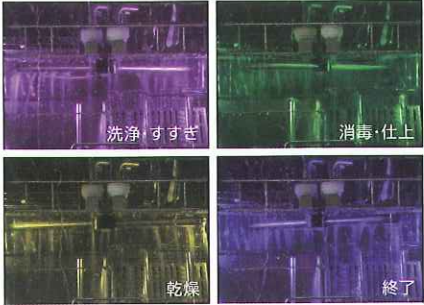
洗浄～乾燥までの工程を色で確認

洗浄室内にはLEDライトを搭載。洗浄・すすぎ、消毒・仕上、乾燥、終了の工程を、色の変化で確認できます。

※下記、表を参照ください。

ハンドピース洗浄アダプターをラインナップ

洗浄室内にハンドピース専用アダプターを搭載。ハンドピース10本、吸引管10本を1度に洗浄・消毒、乾燥することができます。

多彩な洗浄／消毒コースを搭載

「すすぎ10分」から「93℃ 10分洗浄／消毒」まで、多彩なコースを搭載。

滅菌モード	工程	運転時間(目安)
洗浄／消毒 80℃ 10分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒(80℃ 10分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約55～75分
洗浄／消毒 90℃ 5分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒(90℃ 5分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約60～80分
洗浄／消毒 93℃ 10分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒(93℃ 10分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約70～90分
洗浄	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約36～56分
すすぎ	すすぎ	約10分
庫内洗浄／消毒モード	消毒(93℃ 10分) ▶ すすぎ	約45分

※乾燥・仕上剤の工程あり／なしは選択できます。
※供給水が常温の場合は、約15～20分程度長くなります。
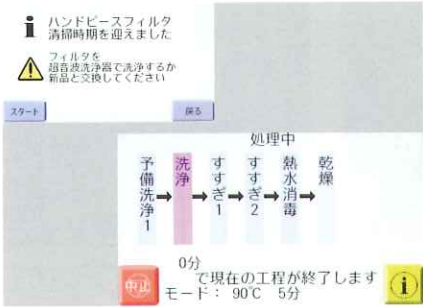
わかりやすい日本語表示のタッチパネル

WD-150は国産製。タッチパネルのディスプレイは全て日本語で表示されますので、洗浄・消毒コースの選択はもちろん、エラーが出た際も一目で内容がわかります。

洗剤は自動で計量・投入

専用の洗剤ボトルをWD-150側面にセットし、チューブで接続。自動で洗浄庫内に必要量が投入されるため、洗浄の度に計量してセットする必要がありません。
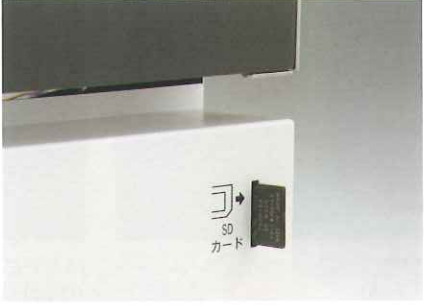
洗浄の記録と設定を本体(約20回分)とSDカードに保存

作業工程の記録と設定内容を保存。データは、本体(約20回分)とSDカードに記録して残しておくことができます。

ハンドピースの洗浄、消毒、乾燥が可能

高温洗浄マークのついているハンドピースの洗浄、消毒、乾燥が可能です。

低温排水装置を搭載

消毒に使用した熱水を冷却して排出する低温排水装置を標準搭載しているため、耐熱排管工事が不要です。

スピーディーな温風乾燥

洗浄・消毒後は、バクテリアフィルターを通した清潔な温風でスピーディーに乾燥します。

国際規格(ISO15883)では、観血処置で使用した器材を熱水消毒するにはウォッシャーディスインフェクターでA_0値3000(90℃ 5分)以上を達成することが求められています。

Item Line up
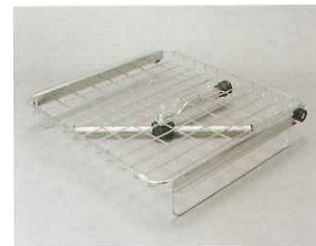
※内側の有効寸法

標準ラック
（上段）
85,000円 272102
W462※×D455※×H27.5mm

ハンドピース用ラック
（上段）
230,000円 272103
W462※×D455※×H49.5mm

インスツルメントスタンド
85,000円 272109
W221×D165×H110※mm

鉗子スタンド
21,000円 272110
W100×D190×H110mm

○下段ラックは付属品です。 ○注文時にどちらか選択していただけます。
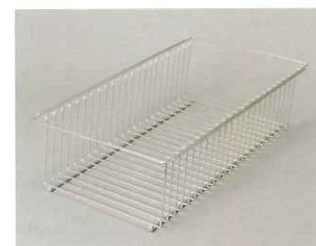
トレースタンド
23,000円 272111
W255※×D445※×H122mm
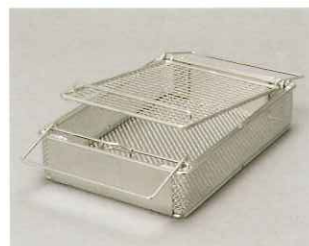
蓋付バスケット
50,000円 272112
W155※×D205※×H49※mm

カセットスタンド
24,000円 272113
W180×D444×H147mm

メッシュバスケット
49,000円 272114
W180※×D445※×H85※mm
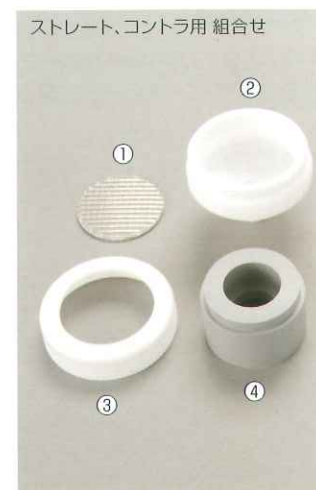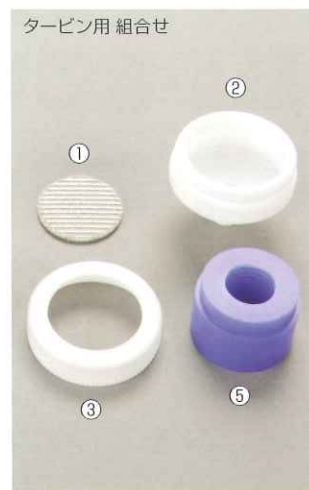
① SUSフィルター（10枚入り）
12,000円 272105
②+③ ハンドピースホルダー（1個）
23,000円 272104
④ シリコンアダプター CA用
（2個入）
3,000円 272107
⑤ シリコンアダプター
タービン用（2個入）
3,000円 272106
⑥ 吸引管立て（10個入）
38,000円 272108

専用 多酵素洗剤 アイエスザイム
2L×4本
18,000円 272115

専用 仕上げ剤 アイエスミルク
2L×4本
18,000円 272116

専用 洗浄槽内洗浄剤
アイエス·テック 500g（5回分）
4,000円 272117

ネスコスI·C W·Iインジケータ
100枚入
11,000円 272118

ネスコスI·C W·Iホルダー

11,300円 272119

BC-17

クラスBオートクレーブ

標準価格:998,000円 272001
販売名:クラスBオートクレーブ BC-17
一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器
機器の分類:管理医療機器（クラスⅡ）/特定保守管理医療機器

医療機器認証番号:225AKBZX00091A01
製造販売:チヨダエレクトリック株式会社
発売:株式会社IHIシバウラ

Specifications

販売名:ウォッシャー·ディスインフェクター WD-150
型式:WD-150
電源電圧:単相200V ±10%
消費電力:15kVA以下
質量:85kg
一般的名称:器具除染用洗浄器
機器の分類:一般医療機器（クラスⅠ）

医療機器届出番号:20B2X10010000002
付属品: 排水ホース（1.5m）×2、SDカード×1

標準価格:1,730,000円 272101

外形寸法:W580×D635×H780+キャスター60mm
槽内寸法:W500×D485×H490mm
除染温度·時間:80℃/10分、90℃/5分、93℃/10分
全行程時間:約10〜90分
乾燥工程:有（温風乾燥）
モード:5パターン
洗浄剤:多酵素洗浄剤·仕上剤

販売
株式会社 モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513 TEL 03. 3834 6161

製造販売　チヨダエレクトリック株式会社
長野県千曲市大字新田124　〒387-0018

発売　株式会社IHIシバウラ

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB: NO. M207.1951-1-000.1311.67,000II-JPC

MICS

Morita Infection Control System
モリタは院内感染予防を総合的にプロデュースします。